

**Florida SHOTS™**

# CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL REGISTRO DE VALORES DE TEMPERATURA DE VACUNAS VFC

## Información de Contacto

[www.flshots.com](http://www.flshots.com)

**Servicio de Ayuda Gratuita:**

877-888-SHOT (7468)

Lunes – Viernes, 8 a.m. a 5 p.m. Hora del este.



## Índice Rápido

ADICIÓN A FLORIDA SHOTS DE INFORMACIÓN ACERCA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS VFC 3

---

ADICIÓN Y ACTUALIZANDO CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 5

---

SUBIR LOS ARCHIVOS DE VALORES DE TEMPERATURAS EN FLORIDA SHOTS 9

---

REGISTRO DE VALORES DE TEMPERATURA 12

---

LISTADO DE INCIDENTES DE EXCURSIÓN 13


---



# 1. ADICIÓN A FLORIDA SHOTS DE INFORMACIÓN ACERCA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS VFC

Esta guía ayuda a los sitios de Vacunas para Niños (VFC, por sus siglas en inglés) a ingresar y administrar en Florida SHOTS los registros de los valores de temperatura. La subida de los valores de temperatura de vacunas VFC desde un termómetro registrador de datos es un requisito.

1. Entre a su sesión de Florida SHOTS.
2. Navegue el menú “**VFC Inventory**”.
3. Haga clic sobre “**Temperature Logs**” que se localiza bajo “**Order**”. Si no posee acceso a este menú y necesita los permisos requeridos, comuníquese con la persona de contacto de VFC, principal o secundaria, en su oficina para habilitar esta función. Si desconoce a los individuos encargados de habilitar esta función, contacte a la oficina del Program VFC a través del 877-888-7468 Opción 1.

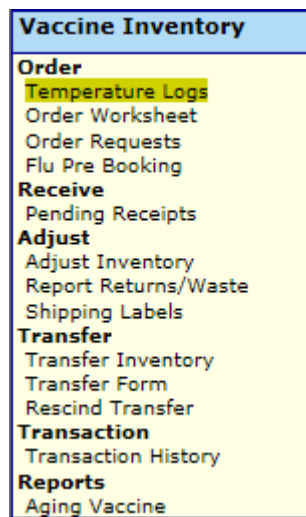

## Adición a Florida SHOTS de información acerca de las unidades de almacenamiento de vacunas VFC

Una vez que haya hecho clic sobre “**Temperature Logs**”, el sistema le mostrará el listado “**Refrigerators/ Freezers List**” donde primero necesitará añadir sus unidades de almacenamiento de vacunas VFC. Seleccione “**VFC Provider PIN**” y “**Identify Refrigerator and Freezers**” de su sitio. Todos los campos en azul son necesarios.

The image shows a screenshot of the 'Refrigerators / Freezers List' form. The form has a header with the title 'Refrigerators / Freezers List' and a 'Training Environ' button. Below the header, there is a dropdown menu for 'VFC Provider:' with three options: 'Pin:501042 W BEACH', 'Pin:501043 BEACH PEDS', and 'Pin:501044 BEACH E'. Below this is a table with columns: 'PIN/EID', 'Identifier', 'R/F', 'Ended Date', and 'Show out-of-service units'. The table is currently empty, with a message: 'No records are on file for the selection criteria.' Below the table is a section for adding a new refrigerator/freezer. It includes fields for 'Pin/VFC EID:', 'Identifier: \*', 'Type: \*' (with radio buttons for 'Refrigerator' and 'Freezer'), 'Manufacturer: \*', 'Model: \*', 'Import Format: \*' (with a dropdown menu), 'Temperature Entry Blocked As of: \*', and 'Service Dates From: \*' and 'Thru: \*'. There is an 'Add' button at the bottom left of this section.

# 1. ADICIÓN A FLORIDA SHOTS DE INFORMACIÓN ACERCA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS VFC (cont.)

- Identificador (Identifier)— Este campo es obligatorio y necesita información específica, particularmente para sitios con múltiples refrigeradores o congeladores. Por ejemplo, si su sitio tiene dos refrigeradores, usted deberá diferenciarlos en Florida SHOTS antes de documentar los valores de temperatura. Para ayudarle a distinguir entre unidades, cada “**Identifier**” deberá incluir lo siguiente: número VFC PIN, un guión, y la palabra “**refrigerator**” o “**freezer**”. En este ejemplo, si el número PIN de su sitio fuera 456789, el segundo refrigerador de su sitio debería entonces utilizar “**456789–Refrigerator2**” como el “**Identifier**”. Necesitará asegurarse que el identificador creado en esta página concuerde con el identificador de su dispositivo (como el LogTag TRED30-7R) el cual identifica el sitio de almacenamiento que está siendo medido.
- Tipo (Type)—Seleccione el botón correcto para indicar si la unidad es un refrigerador o un congelador. Asegúrese de seleccionar correctamente para que el sistema no interprete incorrectamente las diferencias en temperatura. (Las temperaturas admisibles para un refrigerador son significativamente mayores que las admisibles para un congelador)
- Fabricante (Manufacturer)— Introduzca el fabricante del refrigerador o congelador.
- Modelo (Model)— Introduzca el número del modelo del refrigerador o congelador.
- Formato de importación (Import Format)— Este campo se utilizará solamente cuando se trate de un dispositivo de monitoreo de datos de temperatura que haya sido validado por el programa VFC. Este campo deberá ser configurado por la oficina del programa VFC. Una vez que este campo haya sido configurado, usted podrá importar su archivo de registro de datos hacia Florida SHOTS.
- Fechas de servicio (Service Dates)— Deberá introducir en el campo “**Service Dates From**”, la fecha inicial del servicio para esta unidad dentro de Florida SHOTS. Introduzca la fecha de hoy, si coincide con la fecha en la que se está registrando por primera vez la temperatura para dicha unidad dentro del registro de Florida SHOTS. No introduzca ninguna fecha en el campo “**Thru**” a menos que haya determinado que dicho refrigerador o congelador no se usará nunca más para almacenar vacunas VFC. Una de las razones podría ser debido a que la unidad haya parado completamente de trabajar, que no mantenga la temperatura en un rango constante, o que haya comprado una nueva unidad. Cuando haya decidido que la unidad no será utilizada para almacenar vacunas VFC, deberá regresar al campo “**Refrigerators/Freezers List**” e introducir la fecha en el campo “**Thru**” para discontinuar el reporte de valores de temperatura para dicha unidad. En este punto, deberá también añadir una nueva unidad de almacenamiento para que su PIN continúe enviando valores de temperatura de todas las unidades en las que almacena sus vacunas VFC.

Cuando toda la información ha sido entrada para la refrigeradora o congelador, haga clic en “**Add**” para añadir esta unidad al PIN seleccionado en la parte superior de la página.

REFRIGERATORS / FREEZERS LIST Show Help Text

VFC Provider: \* Pin:481046 INTL - MAITLAND CENTER  
Pin:481049 ISLK - SAND LAKE CENTER  
Pin:590022 LMK - LAKE MARY CENTER

PIN/EID	Identifier	R/F	Ended Date	Show out-of-service units
No records are on file for the selection criteria.				

Refrigerator/Freezer

Pin/VFC EID: \*

Identifier: \* 590022-REFRIGERATOR

Type: \*  Refrigerator  Freezer

Manufacturer: \* KENMORE

Model: \* MS56987

Import Format: \* -- Select --

Temperature Entry Blocked As of: \*

Service Dates From: \* 04/25/2016 Thru: \*

## 2. ADICIÓN Y ACTUALIZANDO CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

Después de haber hecho clic sobre “Add”, verá un mensaje de alerta en color verde en el extremo superior de la página comunicándole que su unidad ha sido añadida exitosamente. Verá el PIN/EID junto con el identificador, así como el menú en el extremo derecho, donde podrá actualizar la temperatura e información de la unidad. Al hacer clic sobre “Show Detail”, se mostrará la información que fue introducida para la unidad bajo ese PIN, así como también podrá realizar cambios, o ingresar la fecha “Thru” una vez que se descontinúe el funcionamiento de la unidad.

PIN/EID	Identifier	R/F	Ended Date	Show out-of-service units
P:501043	501043-FREEZER1	F		<input type="checkbox"/>

[Show Detail](#) [Go to Order List for Pin:501043](#)

[Upload Temperatures File](#)  
[Add Missing Temp Reading](#)  
[Temperature Log](#)  
[Excursion Incident List](#)  
[Add Calibration](#)  
[Calibration Log](#)

Refrigerator/Freezer

Pin/VFC EID:  
Identifier: \*  
Type: \*  Refrigerator  Freezer  
Manufacturer: \*  
Model: \*  
Import Format: -- Select -- (from currently in use Calibration record)  
Temperature Entry Blocked As of:  
Service Dates From: \* Thru: \*

### Adición de certificados de calibración

El programa VFC y Florida SHOTS necesitan saber que su unidad de almacenamiento de vacunas VFC presenta un termómetro tanto válido como calibrado, por lo que necesitará documentar el certificado de calibración del dispositivo de monitoreo primario o de respaldo “backup”.

1. Para añadir la información de calibración del dispositivo de monitoreo, haga clic sobre “Add Calibration”

**NOTA:** Necesitará el certificado de calibración para añadir la información en el sistema.

[Upload Temperatures File](#)  
[Add Missing Temp Reading](#)  
[Temperature Log](#)  
[Excursion Incident List](#)  
[Add Calibration](#)  
[Calibration Log](#)

## 2. ADICIÓN Y ACTUALIZANDO CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN (cont.)

**Thermometer**

Manufacturer/Name:

Model Nbr: \*

Serial Nbr: \*

Import Format:

Expiration Date: \*

Is Current for the unit:

Certificate is from an accredited laboratory

Instrument Pass/Fail testing, or In Tolerance

Measurement results for the device: \*

Maximum characters permitted is: 8000. Character count: 0

Documented Uncertainty.  
Measurement results indicate unit passed test and the documented uncertainty is within suitable limits (recommended uncertainty = +/- 1F (0.5C).

Statement that calibration testing conforms to ISO 17025

Entre la siguiente información que se encuentra en el certificado de calibración de su termómetro: “**Manufacturer/Name**” fabricante o nombre, “**Model Nbr**” numero de modelo, “**Serial Nbr**” numero de serial y “**Expiration Date**” fecha de expiración.

Contacte a la oficina del Programa VFC a través del 877-888-7468 Opción 1 para habilitar el campo de “**Import Format**” Formato de Importe.

Si la información de calibración es para el termómetro que esta usando actualmente en la unidad de almacenamiento, marque “**Is Currently for the Unit**”. Si la calibración es para un termómetro de respaldar “**backup**” entonces no la marque. Cuando sea tiempo para usar el termómetro de respaldar en la unidad, simplemente entre al “**Calibration Log**” de la unidad y marque la casilla “**Current for the Unit**” del termómetro.

### Adición de certificado de calibración de laboratorio acreditado

Si tiene un certificado de calibración de un laboratorio acreditado, deberá seleccionar las casillas de “**Certificate is from an accredited laboratory**” y después el elegir el laboratorio. Haga clic en “**Calibration Report Examples**” en la parte superior de la página para asistencia adicional para completar.

**Update Calibration Record**

Provider Pin: 291006 Site: OSBORNE CENTER in TAMPA FAMILY HEALTH CENTERS  
Freezer: 291006FREEZER3

Help with completing this form: [Calibration Report Examples](#)

**Thermometer**

Manufacturer/Name:

Model Nbr: \*

Serial Nbr: \*

Import Format:

Expiration Date: \*

Is Current for the unit:

Certificate is from an accredited laboratory

Laboratory: \*

Documented Uncertainty.  
Measurement results indicate unit passed test and the documented uncertainty is within suitable limits (recommended uncertainty = +/- 1F (0.5C).

[Go to Order List for Pin:291006](#)

[Return to Refrigerators/Freezers List](#)

## 2. ADICIÓN Y ACTUALIZANDO CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN (cont.)

Haga clic sobre “**Add**”. Un mensaje en letras verdes aparecerá en el extremo superior de la pantalla indicándole que la calibración ha sido exitosamente añadida. Necesitará añadir una nueva calibración cada vez que el certificado de calibración del termómetro haya llegado a su fecha de vencimiento.

### Adición de un certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado

Si tiene un certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado, deberá introducir los resultados de las medidas en la casilla “**Measurement results for the device**” y seleccionar las casillas para lo siguiente:

- “Instrument Pass/Fail testing, or In Tolerance”
- “Documented Uncertainty”
- “Statement that Calibration Testing Conforms to ISO 17025”

**NOTA:** Toda la información necesaria para completar este paso se muestra en el certificado del termómetro.

Thermometer

Manufacturer/Name:	LOG TAG
Model Nbr: *	TRED-30
Serial Nbr: *	SKJDHFKSDJHF
Import Format:	-- Select --

Expiration Date: \* 09/12/2020

Is Current for the unit:

Certificate is from an accredited laboratory

Instrument Pass/Fail testing, or In Tolerance

Measurement results for the device: \*

Maximum characters permitted is: 8000. Character count: 0

**Documented Uncertainty.**  
Measurement results indicate unit passed test and the documented uncertainty is within suitable limits (recommended uncertainty = +/- 1F (0.5C).


**Statement that calibration testing conforms to ISO 17025**

Haga clic sobre “**Add**”. Un mensaje en letras verdes aparecerá en el extremo superior de la pantalla indicándole que la calibración ha sido exitosamente añadida. Necesitará añadir una nueva calibración cada vez que el certificado de calibración del termómetro haya llegado a su fecha de vencimiento.


## 2. ADICIÓN Y ACTUALIZANDO CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN (cont.)

Si el dispositivo de registro de temperatura continuo primario no esta funcionando correctamente o siendo recalibrado tendrá que usar dispositivo de respaldar “**backup**”. Se requiere ingresar el certificado de calibración por ambos termómetros. Habilitando el “**Import File Format**” para el termómetro respaldar “**backup**” le permitirá subir los archivos de valores de temperatura sin interrupciones o tener que llamar al Programa de VFC. Simplemente cambiara los dispositivos dentro de Florida SHOTS.

1. A la derecha de la unidad, haga clic sobre “**Calibration Log**” para ver los detalles de los termómetros actuales y de respaldar.



2. Para cambiar el estado de su termómetro de respaldar para el termómetro actual de la unidad, marque la casilla “**Current for Unit.**”

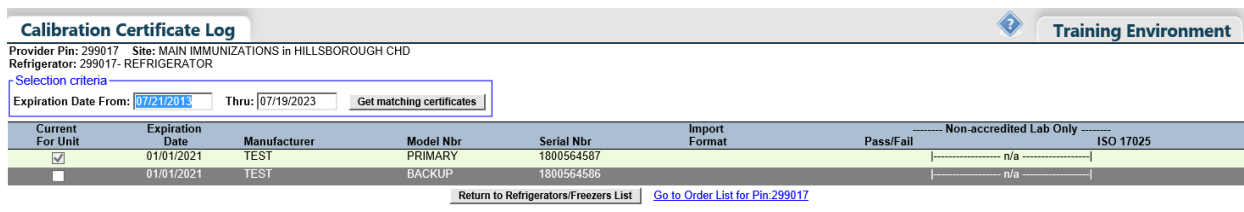

Calibration Certificate Log Training Environment

Provider Pin: 299017 Site: MAIN IMMUNIZATIONS in HILLSBOROUGH CHD  
Refrigerator: 299017- REFRIGERATOR

Selection criteria  
Expiration Date From: 07/21/2018 Thru: 07/19/2023 [Get matching certificates](#)

Current For Unit	Expiration Date	Manufacturer	Model Nbr	Serial Nbr	Import Format	Pass/Fail	Non-accredited Lab Only	ISO 17025
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2021	TEST	PRIMARY	1800564587			n/a	
<input type="checkbox"/>	01/01/2021	TEST	BACKUP	1800564586			n/a	

[Return to Refrigerators/Freezers List](#) [Go to Order List for Pin 299017](#)

**NOTA:** Aparecerá una ventana emergente para confirmar que desea cambiar el termómetro en el sistema, haga clic sobre “**OK**” y la unidad será actualizada con el termómetro nuevo o de respaldar “**backup**”.



### 3. SUBIR LOS ARCHIVOS DE VALORES DE TEMPERATURAS EN FLORIDA SHOTS

#### Subir Los Archivos De Valores De Temperaturas en Florida SHOTS

Al menos una vez cada siete días, los registros de temperatura deberán ser ingresados en Florida SHOTS.

Si no añadiera valores de temperatura en siete días laborables consecutivos para ninguna de las unidades que su sitio ha incluido en Florida SHOTS como unidades de almacenamiento de vacunas VFC, verá **“Readings Overdue”** señalado en letras rojas cuando haga clic sobre **“Temperature Logs”**, que se localiza en **“Vaccine Inventory”**.

PIN/EID	Identifier
P:291069	291069-REFRIGERATOR <b>(Readings Overdue)</b>

Si su pedido es suspendido porque faltan datos de temperatura, haga clic sobre el botón azul **“I”** para ver la lista de los datos de temperatura faltantes. Si dichos datos tienen más de 180 días, Contacte a la oficina del Programa VFC a través del 877-888-7468 Opción 1.

**NOTA:** Cuando se ingrese a Florida SHOTS, será notificado con una nota en **“User Task List”** que le da un mensaje de **“Missing Temperatures Reading.”** Será dirigido a la página de **“Temperature Logs”** si no tiene ninguna otra tarea pendiente.

User Task List		
Item #	Group Desc	Item Description
1		To-be Certified Form 680s
2	Temperature Logging	Missing Temperature Reading

#### Subida de un archivo de lecturas de temperatura a través de un registrador de datos

Para poder subir un archivo de lecturas de temperatura a través de un registrador de datos, el dispositivo a usar deberá ser primero validado por el programa VFC. El campo **“Import Format”** para la unidad de almacenamiento deberá ser configurado por la oficina del programa VFC. Una vez que este campo haya sido configurado por la oficina del programa VFC, usted podrá entonces importar hacia Florida SHOTS el archivo proveniente del registrador de datos.


Import Format:

Haga clic sobre **“Upload Temperatures File”**.


- [Upload Temperatures File](#)
- [Add Missing Temp Reading](#)
- [Temperature Log](#)
- [Excursion Incident List](#)
- [Add Calibration](#)
- [Calibration Log](#)

### 3. SUBIR LOS ARCHIVOS DE VALORES DE TEMPERATURAS EN FLORIDA SHOTS (cont.)


Se mostrará la página “Upload Temperature Log File”. Haga clic sobre “Browse” para encontrar, en su computadora, la carpeta donde guarda los archivos de datos. Seleccione el archivo de datos que desea importar, y este aparecerá en la casilla que se localiza bajo “Temperature Log File”. Haga clic sobre “Upload Temperature Readings File”. Esta acción permitirá que se importe el archivo de registros de temperatura hacia Florida SHOTS.

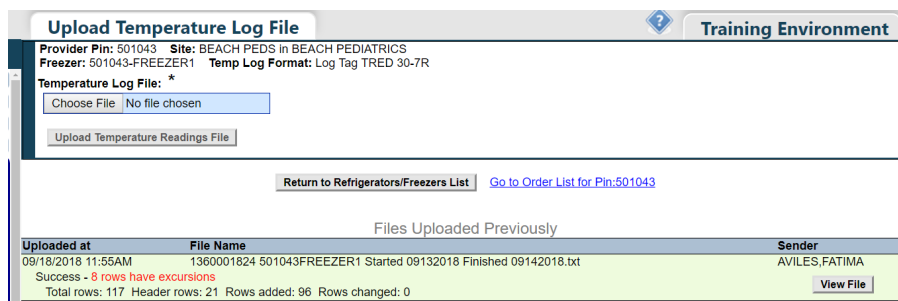

**NOTA:** En el extremo superior de la pantalla, se mostrará un mensaje en letras verdes indicando que los datos han sido exitosamente añadidos (se mostrará un mensaje en rojo si no fuesen añadidos). También se mostrará el número total de filas “Total Number of Rows” dentro del archivo, así como el número total de filas de datos que fueron añadidas e ignoradas. Haga clic sobre “View File” para ver el momento en que se comenzaron y se terminaron de registrar los valores de temperatura en dicho archivo, los horarios y valores de temperatura que fueron añadidos a esta unidad en Florida SHOTS, y los valores que fueron ignorados. Para más detalles sobre los errores y la subida de archivos de temperatura en Florida SHOTS, por favor visite la sección “Guías” en [www.flshotsusers.com](http://www.flshotsusers.com).

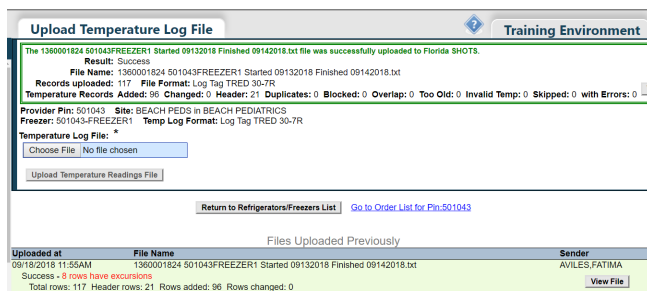


Si el archivo que subió contiene excursiones de temperatura, vera el numero de filas que contienen las excursiones al lado del estado del archivo. Debes de contactar a la oficina del Programa de VFC para reportar excursiones.

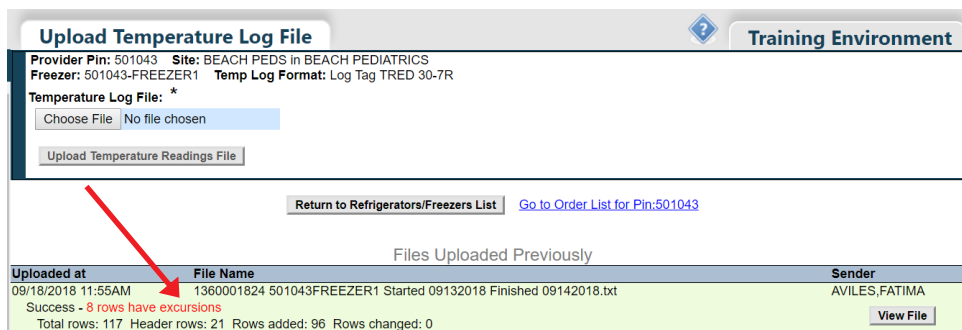

### 3. SUBIR LOS ARCHIVOS DE VALORES DE TEMPERATURAS EN FLORIDA SHOTS (cont.)

#### Adición de lecturas de temperatura faltantes

En algunos momentos, podría suceder que la lectura de temperatura que debía haber sido realizada no se efectuó. La página “Add Missing Temp Reading” le permitirá ofrecer una explicación de lo sucedido al programa VFC en el periodo de tiempo en específico.



**NOTA:** Contacte al Programa de VFC si no puede entrar una temperatura faltante.

Para reportar una lectura faltante, necesitará ingresar la fecha inicial y hora, así como la fecha final y hora para el periodo de tiempo en el que las lecturas no fueron realizadas o registradas. Asegúrese de definir correctamente AM o PM para el tiempo ingresado. Como mismo ocurre al introducir manualmente los valores de temperatura, la hora podrá ser ingresada sin los dos puntos siempre y cuando existan al menos tres dígitos.

Seleccione en la lista siguiente la razón por la cual no se registró la temperatura. Sus opciones son:

- No se realizó (Did not take)
- Fuera de servicio (Out of commission)
- Fallo de energía (Power Outage)
- Consultorio cerrado/día festivo (Practice holiday/closing)

Por ultimo haga clic sobre “Add” para que Florida SHOTS documente la lectura de temperatura faltante para dicha unidad. Aparecerá un mensaje en letras verdes, en el extremo superior de la pantalla, indicándole que el registro ha sido añadido exitosamente.

## 4. REGISTRO DE VALORES DE TEMPERATURA

### Registro de valores de temperatura

Usted será capaz de ver una lista, organizada por fecha, de todas las temperaturas dentro del sistema. Necesitará hacer clic en la fecha dentro del registro para ver las temperaturas específicas que ha subido o ingresado para la unidad en esa fecha. Florida SHOTS está configurado, de forma predeterminada, para un rango de siete días. Podrá modificar las fechas mediante la introducción de fechas diferentes y al hacer clic sobre **“Get Matching Readings.”** También podrá acceder a la opción **“Show only readings with excursions”**.



En la lista **“Temperature Log”** podrá ver el momento en que la lectura fue realizada, la temperatura actual, los rangos de temperatura mínimos y máximos, la temperatura ambiente, así como la existencia de excursiones fuera del rango de temperatura apropiado.

Provider Pin: 520073 Site: ST PETE PEDS SOUTHSIDE in ST PETERSBURG PEDIATRICS  
Refrigerator: 520073-REFRIGERATOR

Selection criteria

Reading Taken Date From: 03/23/2016 Thru: 03/30/2016

Show only readings with Excursions  Get matching readings

Date	Readings		Curr Temp		Max Temp		Min Temp		Missing	
	Taken	w/Exc.	High	Low	High	Low	High	Low	Rptd.	w/Exc.
03/23/2016	96	2	46.9°F	35.4°F					0	0
03/24/2016	96	0	43.7°F	36.9°F					0	0
03/25/2016	96	0	42.3°F	35.1°F					0	0
03/26/2016	96	0	39.4°F	35.8°F					0	0
03/27/2016	96	0	38.1°F	34.9°F					0	0
03/28/2016	96	0	37.2°F	34.5°F					0	0
03/29/2016	96	0	37.9°F	34.2°F					0	0
03/30/2016	53	3	39.2°F	33.6°F					0	0

Usted también tendrá un enlace en **“Temperature Log”**, para ver si la oficina VFC ha determinado que una excursión forma parte de un **“Excursion Incident”**. El enlace que lee **“See Excursion Incident”** será mostrado en cada línea del **“Temperature Log”** correspondiente a la excursión que la oficina del programa VFC ha determinado que constituye un incidente.

## 5. LISTADO DE INCIDENTES DE EXCURSIÓN

**NOTA:** Usted tiene que contactar al Programa de VFC para reportar excursiones.

### Listado de incidentes de excursión

La oficina del Programa VFC contactará su oficina, cuando se cree un incidente, para pedirle que proporcione información relacionada con dicho incidente. Al hacer clic sobre **“Excursion Incident List,”** deberá seleccionar el incidente al que se está refiriendo en ese instante si hubiese más de un incidente en la lista. Esta acción le llevará a la página **“Update Incident Record”**.

### UPDATE INCIDENT RECORD

<b>Provider Pin:</b> 487002	<b>Site:</b> SUNSHINE 1 in ORANGE CHD
<b>Freezer:</b> 487002-MAIN FREEZER	
<a href="#">Most Recent Readings</a>	
<b>Taken:</b> 10/24/2014 05:01PM IM <b>Current:</b> 3.0°F <b>Min:</b> n/a <b>Max:</b> n/a <b>Room:</b> n/a	
<b>Excursion(s):</b> Current	
<b>From:</b> 10/21/2014 07:40PM	
<b>Thru:</b> 10/22/2014 03:40AM	
<b>Range From:</b> 10/21/2014 07:25PM	
<b>Range Thru:</b> 10/22/2014 03:55AM	
<b>Resolution Date:</b>	
<b>Latest Update:</b> 10/28/2014 10:54AM	
<a href="#">Accum Excursion Time</a>	
<b>In Days:</b> 2	
<b>In Hrs:</b> 2.00	
<b>In Mins:</b> 120	
<b>Cause:</b>	<input type="text"/>
Maximum characters permitted is: 8000. Character count: 0	
<b>Result:</b>	<input type="text"/>
Maximum characters permitted is: 8000. Character count: 0	

## 5. LISTADO DE INCIDENTES DE EXCURSIÓN (cont.)

---

Verá los siguientes detalles sobre el incidente: Provide PIN, site, and unit information

- Proporcionar PIN, sitio e información sobre la unidad
- Lecturas más recientes “**Most Recent Readings**” registradas para la unidad
- (Excursión) From (fecha y hora)
- (Excursión) Thru (fecha y hora)
- Rango desde “**Range From**” (fecha y hora)
- Rango hasta “**Range Thru**” (fecha y hora)
- Fecha de resolución “**Resolution Date**” (si existe una): Este campo debe quedarse en blanco si se trata de un incidente abierto.
- Última actualización “**Latest Update**”: Muestra la fecha y hora de la última actualización documentada de un incidente en Florida SHOTS.
- Tiempo de excursión acumulado “**Accumulated Excursion Time**”: Suma los plazos de todas las temperaturas fuera del rango. Elimina los plazos en que las temperaturas oscilaron dentro del rango. Esta información es muy valiosa cuando se comunica a los fabricantes la viabilidad de la vacuna. Como usted sabe, algunas vacunas siguen siendo viables después de haber sido expuestas, hasta un cierto número de horas, a temperaturas fuera de la gama. Tener datos con este nivel específico de detalles, que se puedan proporcionar a los fabricantes, ayuda a la oficina del programa VFC en la determinación de la viabilidad de las vacunas.

Los otros campos de esta página serán documentados por su oficina. Usted será responsable de:

- Causa “**Cause**” (causa del incidente)
- Acción tomada “**Action Taken**”
- Resultado “**Result**” (resultado de la acción tomada)

Por favor, recuerde que el programa VFC trabajará en estrecha colaboración con su oficina en caso de un incidente.